

**Odp.1**

Zadanie realizowane na podstawie „Umowy o Partnerstwie” na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9,2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, zawarta na podstawie art.33 ust1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U.2018 poz.1431, ze zm) w związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa w dniu 04 maj 2020.

**Znak sprawy: DZP-271-4/20/TA**

**Brzesko 07.07.2020 r.**

**Wykonawcy wszyscy  
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę „Urządzeń medycznych”, ogłoszonego w DUUE nr:288577-2020.

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, informuje:

**Pytanie nr: 1 - Zadanie nr: 4 –Zamrażarka laboratoryjna szt 1**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 96 litrów, tj. o tylko 4 litry mniejszej od wymaganej?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr: 2 - Zadanie nr: 4 –Zamrażarka laboratoryjna szt 1**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z panelem sterowania z przyciskami membranowymi?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr: 3- Zadanie nr: 5 Chłodziła laboratoryjna– 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z agregatem wbudowanym na dole urządzenia?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr: 4- Zadanie nr: 5 Chłodziła laboratoryjna– 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze sterownikiem z menu w j. angielskim?

**Odp: Nie dopuści.**

**Pytanie nr: 5 -Zadanie nr: 6 Lampa UV przepływowa – szt 4**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę bakteriobójczą przepływową z wymuszonym obiegiem powietrza (25 lat na rynku) z promiennikami 2x55W = 110W. Lampa pracuje w obecności ludzi. Wyniki skuteczności dezynfekcji potwierdzone badaniami.

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr:6 – Zadanie nr:1 , część nr: 2 – wirówka bez chłodzenia.**

W części 2 „ Wirówka bez chłodzenia w pkt 15 Zamawiający wymienia zakres temperatury wirówki -10°C do +40°C. Czy Zamawiający może potwierdzić, że jest zainteresowany urządzeniem bez chłodzenia a wpis w pkt 15 jest omyłką?

**Odp: Tak. Zamawiający jest zainteresowany wirówką bez chłodzenia, parametr „ Temperatura od - 10°C do +40°C” został omyłkowo wpisany. Przepraszamy za pomyłkę.**

**Pytanie nr: 7 Zadanie nr 1 – wirówka 1 oraz 2**

Proszę Zamawiającego o doprecyzowanie wymiarów wyspecyfikowanych probówek o średnicy 12mm poprzez podanie jej wysokości, pojemności oraz podanie nazwy handlowej.

**Odp: Probówki 12 mm x 100mm - poj 7 ml. oraz 12 mm x 75 mm – poj. 5 ml**

**Pytanie nr: 8 Zadanie nr 1 – wirówka 1 oraz 2**

Czy celem zwiększenia konkurencyjności i ilości składanych ofert Zamawiający zgodzi się i dopuści wirówki laboratoryjne o większej pojemności wirnika horyzontalnego niż maksymalnie 4x145ml spełniający warunek minimalnej ilości wirowanych w nim próbek, bez systemu beznarzędziowego mocowania wirników, bez systemu ciągłego pomiaru drgań, oferujące ponad 90 programów użytkownika z łatwego i intuicyjnego menu wirówki bez bezpośredniego dostępu?

**Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr: 9 Zadanie nr 1 – wirówka 1 oraz 2**

Czy Zamawiający dopuści wirówki o niewiele niższym przyspieszeniu maksymalnym wynoszącym ponad 30000 xg gdzie parametr ten nie wpływa na wymagany wirnik horyzontalny? Z racji swojej budowy, konstrukcji oraz maksymalnego obciążenia taki typ wirnika nie osiąga takich parametrów pracy.

**Odp: Zamawiający pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr: 10 -Pakiet nr 4**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach zewnętrznych (Sz x G x W) 830x 775x830mm?

Jedynie głębokość jest o 55 mm większa od wymagań Zamawiającego.

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr: 11 Pakiet nr:4**

Czy nie doszło do błędu w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie nr 2 ?

Zamrażarka żeby mroziła musi być wyposażona w kompresor.

**Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.**

**Pytanie nr: 12 Pakiet nr:4**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z zakresem temperatur – 86 do – 40C?

Prosimy o podanie jakie materiały będą przechowywane w zamrażarce.

**Odp. Dopuszcza. W zamrażarce będą przechowywane szczepy wzorcowe alert patogeny, odczynniki diagnostyczne.**

**Pytanie nr: 13 Pakiet nr:5**

Prosimy o wyjaśnienie, czy podane pojemności są brutto czy są to pojemności użytkowe

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemność użytkową chłodziarki 182 L, pojemność zamrażarki 97L? Pojemność użytkowa chłodziarki jest o 2 L mniejsza od wymagań Zamawiającego.

**Odp: Pojemność użytkowa. Zamawiający dopuści proponowaną pojemność.**

**Pytanie nr: 14 Pakiet nr:5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z zakresem temperatur

Chłodziarka +2 do +8 C

Zamrażarka -20 do -40 C

Zgoda na powyższe pozwoli nam zaoferować urządzenie z innymi dodatkowymi elementami wyposażenia:, tzn. Alarm otwartych drzwi, alarm wysokiej i niskiej temperatury, alarm braku zasilania, alarm nieprawidłowego działania czujnika.

**Odp: Tak , dopuści.**

**Pytanie nr: 15 Pakiet nr:5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z agregatem na dole urządzenia.

Jednocześnie chcemy nadmienić, że chłodziarko –zamrażarka jaką chcemy zaproponować wyposażona jest 2 niezależne od siebie kompresory. **Oznacza to, że można niezależnie od siebie wyłączyć chłodziarkę lub zamrażarkę w zależności od potrzeb użytkownika.**

Prosimy o wyjaśnienie , jakie jest merytoryczne uzasadnienie wymogu agregatu wbudowanego na górze urządzenia.

**Odp: Tak, wyrażamy zgodę.**

**Pytanie nr: 16 Pakiet nr:5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z systemem No Frost w części chłodniczej? Jeśli nie proszę o wyjaśnienie.

**Odp: Tak, wyrażamy zgodę.**

**Pytanie nr: 17 Pakiet nr:5**

Prosimy o odstąpienie od wymogu drzwi zamykanych na klucz dla chłodziarki i zamrażarki i wymogu automatycznego domknięcia drzwi dla chłodziarki.

Chłodziarko-zamrażarka jaką chcemy zaproponować posiada 2 zamki/ zatrzaski, które uniemożliwiają przypadkowe otwarcie drzwi jak ilustruje rysunek poniżej. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody prosimy o argumentację.



**Odp:** Zamawiający wymaga zamykania na klucz z uwagi na przechowywanie w nich odczynników diagnostycznych i testów zawierających substancje szkodliwe.


**Pytanie nr: 18 Pakiet nr:5**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie dla wnętrza zamrażarki koszo-szuflad wykonanych ze stali malowanej proszkowo, jak ilustruje rysunek poniżej. 2 kosze + zabezpieczenie panelem z plexi oddzielnie dla każdego elementu.

**Odp:** Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

**Pytanie nr: 19 Pakiet nr:5**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie dla chłodziarki wyposażenia w postaci 3 regulowanych półek ze stali nierdzewnej i szuflady ze stali nierdzewnej.

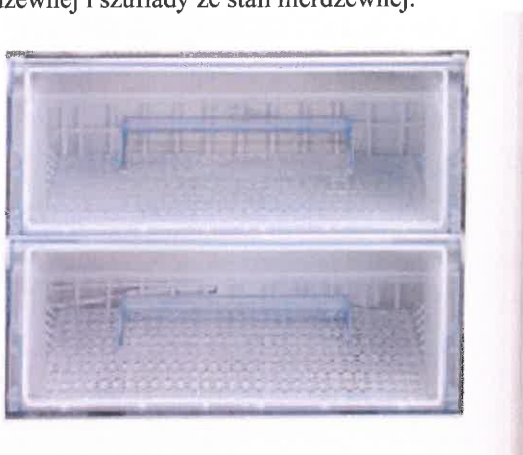

**Odp:** Wyrażamy zgodę.

**Pytanie nr: 20 Pakiet nr:5**

Prosimy o wyrażenie zgody na menu sterownika w języku angielskim z czytelnymi intuicyjnymi ikonami. Jednocześnie informujemy, że instrukcja obsługi zawiera dokładne tłumaczenia i nie stanowi problemu dla użytkownika w obsłudze chłodziarko – zamrażarki.

**Odp:** Wyrażamy zgodę.

**Pytanie nr: 21 Pakiet nr:5**

Prosimy o odstąpienie od wymogu panelu sterowniczego z wyświetlaczem cyfrowym wskazującym datę i godzinę.



Urządzenie jakie chcemy zaproponować, posiada wyświetlacz cyfrowy wskazujący temperaturę wewnątrz urządzenia ( chłodziarki i zamrażarki), temperaturę otoczenia. Jednocześnie informujemy, że temperatura wewnątrz chłodziarki i zamrażarki rejestrowana jest co 1 minutę i takie dane są zgrywane na Pendriva i widoczne w pliku Excel. Jest to wystarczające do monitorowania temperatur.

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o wyjaśnienie.

**Odp: Wyrażamy zgodę.**

**Pytanie nr: 22 Pakiet nr:5**

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem czujnik temperatury. Czy chodzi o alarm nieprawidłowego czujnika/sensora m.in. temperatury, który jest standardem w tego typu urządzeniach.

**Odp: Całodobowy monitoring temperatury wewnątrz urządzenia.**

**Pytanie nr: 3 5**

Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie? Czy jest winda towarowa w budynku? Czy będzie konieczność przemieszczenia zamrażarki po schodach ? Ma to znaczenie dla wyceny transportu.

**Odp: Pracownia zlokalizowana jest na I piętrze. Transport urządzeń odbędzie się windą.**

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
SP ZOZ w Brzesku

*Krystyna Nowak*